Bronkhorst® HIGH-TECH

Dok.nr.: 9.18.103A
Datum: 14-01-2014

RS232

E-8000 CEM Regler
Anschlussplan

RS232 Anschluss

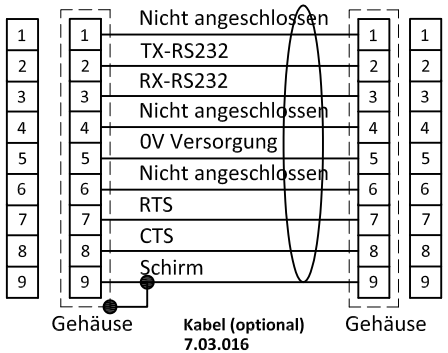

Hinweis:
Pin 7 RTS und pin 8 CTS sind intern verbunden.

Hinweis:
Einspeisen ein einziges Instrument ist nicht von der D-Sub-Anschluss möglich.
Für ein richtiger anschluss siehe Dok.Nr.9.18.062.

9 pol D-Sub Stecker Chassisteil Weiblich

9 pin D-Sub connector cable part male

RS232 COM -port 9 pol D-Sub Stecker Chassisteil Männlich

Erklärung Modellschlüssel

E-8	n	n	n	-	A	-	n	W	a	a	a	-	.....	

Bus Option
RS232 A

Frontplatte
0 Blind
1 1 Anzeige met Bedienung

Rückplatte
W... CEM

Ext. Analoger Sollwert und Ausgang
0 keine
A 0-5 Vdc
B 0-10 Vdc
F 0-20 mAdc aktiv
G 4-20 mAdc aktiv
Z Spezifiziert

Analoger Sensor
T PT100 Temperatur
Z Spezifiziert

Analogaktor
U W100/W200
V W300
Z Spezifiziert

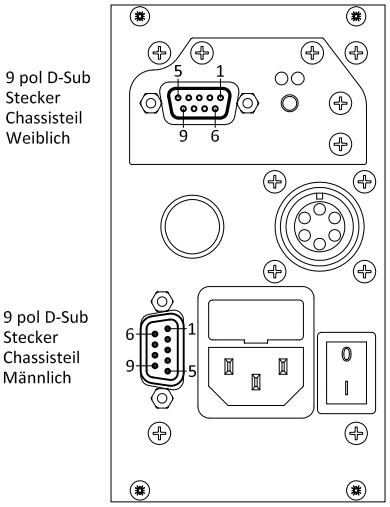

Hinweis: Bild ist ein Beispiel W100/W200.

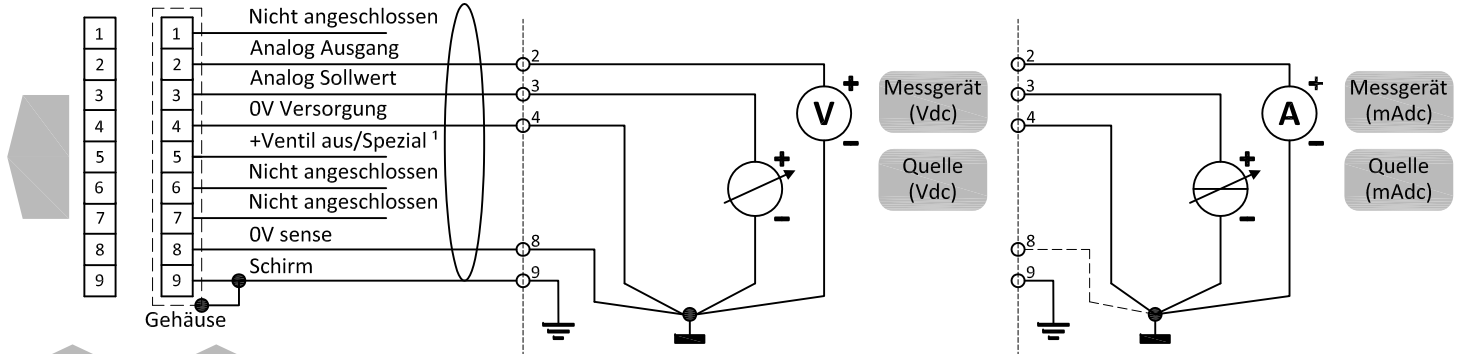

9 pol D-Sub Stecker Chassisteil Männlich

9 pol D-Sub Stecker Kabelteil Weiblich

Hinweis:
Am Gerät kann kein separates Ventil angeschlossen werden.

Hinweis:
¹) +Ventil ist 0...10Vdc 1mA

Analoger Betrieb 0...5 or 0...10Vdc

Analoger Betrieb 0...20 or 4...20mAdc

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschlüss vorzugeben. Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.