Bronkhorst® HIGH-TECH

Dok.nr.: 9.18.106A
Datum: 14-01-2014

# DeviceNet ™

E-8000 CEM Regler
Anschlussplan

## DeviceNet Anschluss

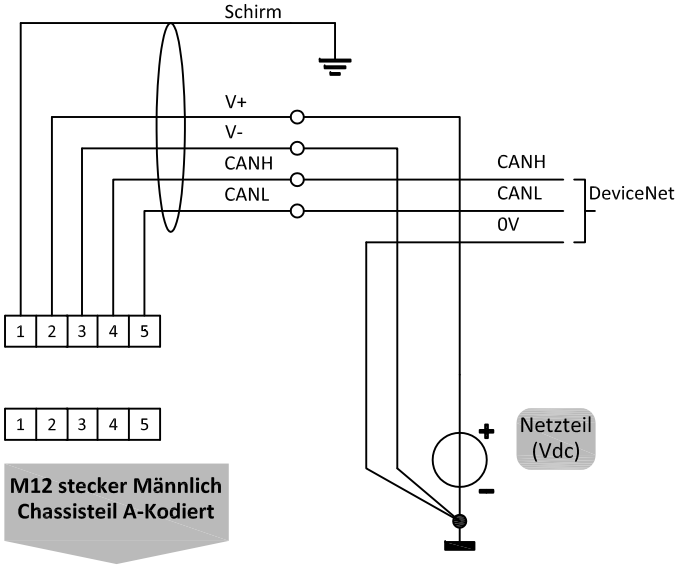


**M12 stecker Männlich Chassisteil A-Kodiert**

## Erklärung Modellschlüssel

Bus option
DeviceNet D

Frontplatte
0 Blind
1 1 Anzeige met Bedienung

Rückplatte
W... CEM

Ext. Analoger Sollwert und Ausgang
0 keine
A 0-5 Vdc
B 0-10 Vdc
F 0-20 mAdc aktiv
G 4-20 mAdc aktiv
Z Spezifiziert

Analoger Sensor
T PT100 Temperatur
Z Spezifiziert

Analogaktor
U W100/W200
V W300
Z Spezifiziert

E-8 n n n - D - n W a a a - .....

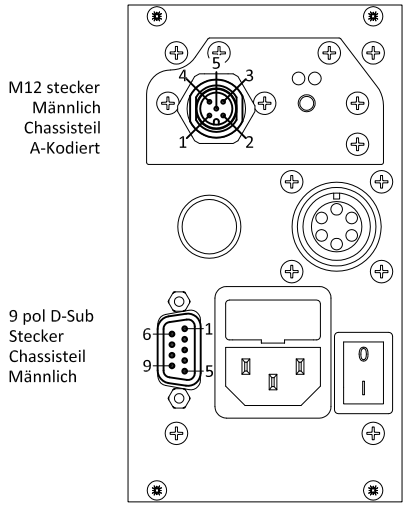


Hinweis: Bild ist ein Beispiel W100/W200.

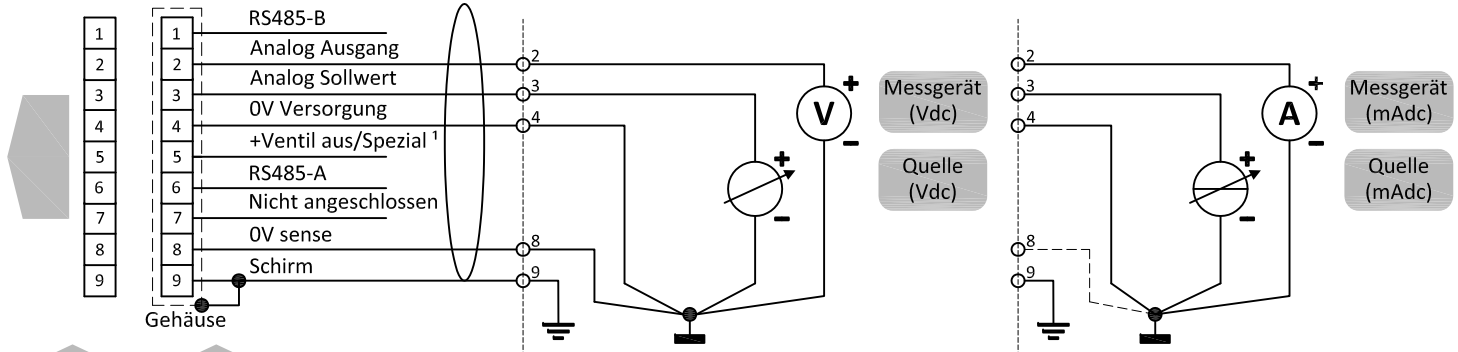


**9 pol D-Sub Stecker Chassisteil Männlich**

**9 pol D-Sub Stecker Kabelteil Weiblich**

Hinweis:
Am Gerät kann kein separates Ventil angeschlossen werden.

Hinweis:
¹) +Ventil ist 0...10Vdc 1mA

**Analoger Betrieb 0...5 or 0...10Vdc**

**Analoger Betrieb 0...20 or 4...20mAdc**

Hinweis:
Bei Ansteuerung eines Gerätes über Feldbus oder RS232 ist der Parameter 'control mode' zu verändern, um einen Sollwert über den analogen D-sub Anschlüss vorzugeben. Für weitere Informationen siehe Dok.Nr. 9.19.023.