Bronkhorst®

Dok.nr.: 9.18.116C
Datum: 05-01-2017

CEM W-303B 110...120Vac an einem Nicht-Bronkhorst-Steuergerät.

CEM system
Anschlussplan

⚠ Warnung ⚠

Das CEM besitzt keine Sicherung.
Im geregelten Heizkreis muss jedoch eine Sicherung vorgesehen werden.
Empfohlene Sicherung: 16A langsam

Die Sicherung darf nicht im Heizkreis montiert werden.

Das CEM muss in eine Temperaturkontroll-Einheit integriert werden.

Der Temperatursensor Typ PT100 muss ein Teil des Kontroll- und Sicherheitssystems sein.

Sicherheitsschalter

Pepi Miniatur Thermostat Modell C
Die Kontakte öffnen sich bei ansteigender Temperatur, die
Betriebstemperatur beträgt 200 °C ±7 K für das Thermostat.
Achtung: Gehäuse steht unter Strom und ist mit NOMEX-Hülsen isoliert.
Die Schaltleistung beträgt 12/24 Vdc, 3 A max.
Das Thermostat ist nicht für Wechselstrom geeignet.

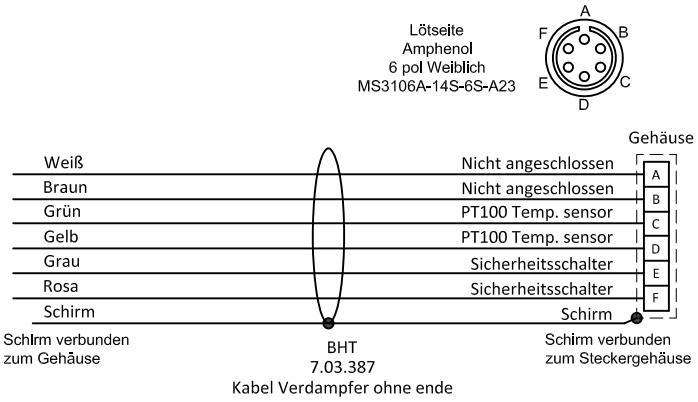

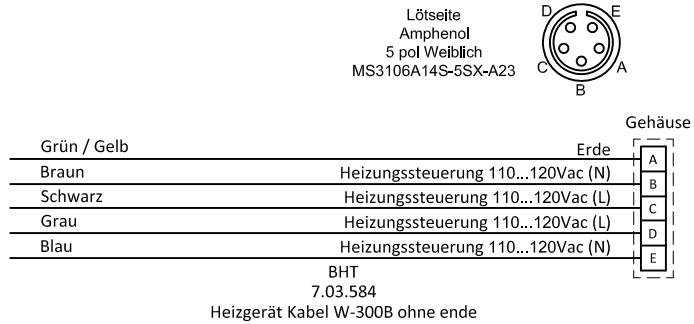

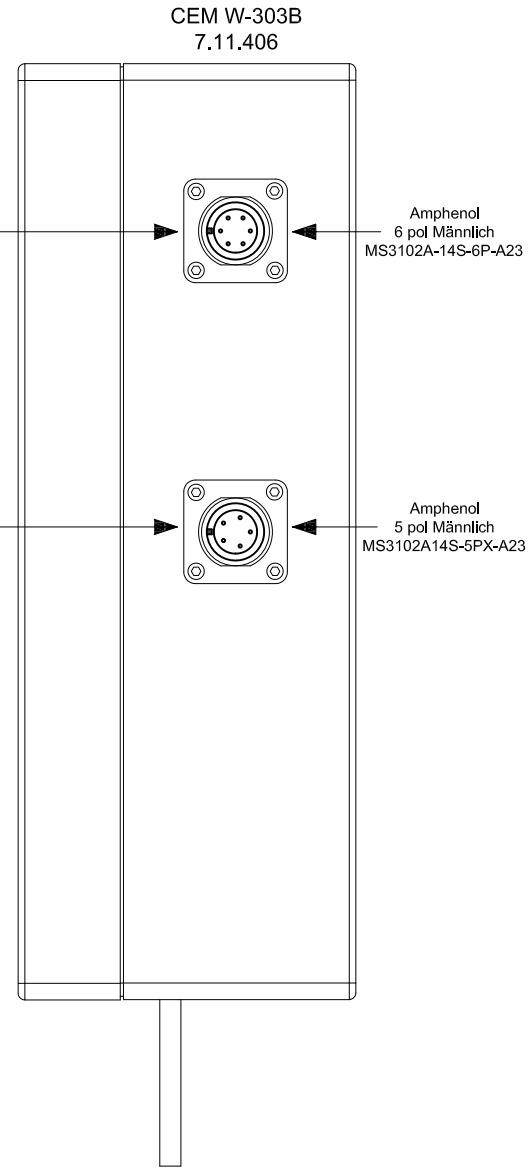
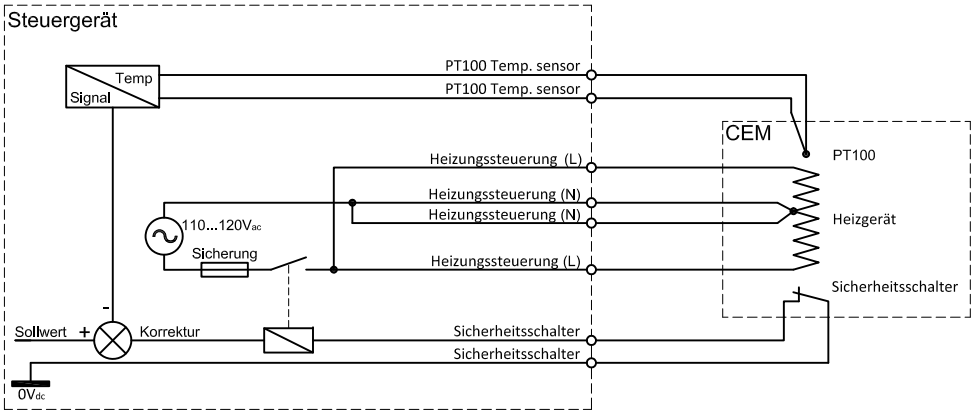
Elektrischer Schaltplan für den Heizkreis: